




คู่มือการรายงานผลระบบออนไลน์
โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ภูมิคุ้มกันวิทยาโดยองค์กรภายนอก
Syphilis serology

1. เข้าสู่เว็บไซต์ <https://eqamt.mahidol.ac.th/>

1.1 LOGIN เข้าสู่ระบบด้วย “E-mail และ Password”

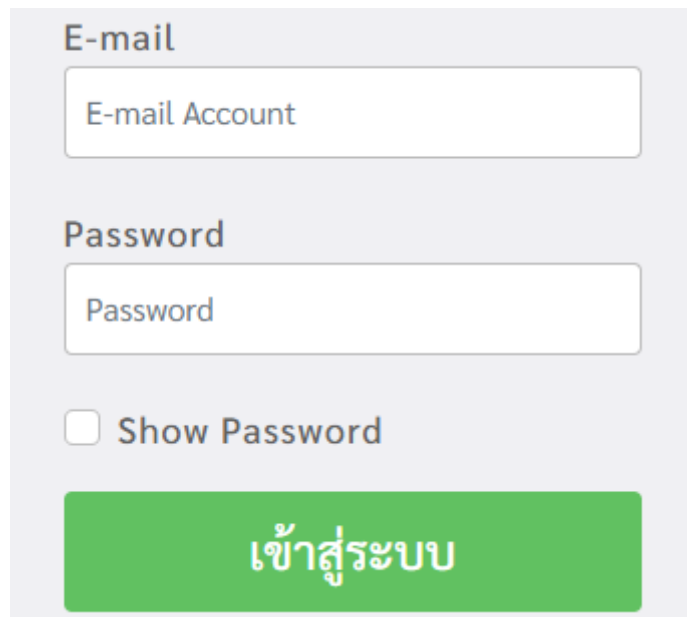

E-mail

E-mail Account

Password

Password


Show Password

เข้าสู่ระบบ


2. เข้าสู่ระบบสำเร็จ หน้าต่างเว็บไซต์จะปรากฏ “ID สมาชิก 8 หลัก และ E-mail” ด้านมุมขวาบน




2.1 คลิก “ส่งผลการทดสอบ” จากเมนูด้านซ้ายและคลิก “ส่งผลการทดสอบปี 2023”

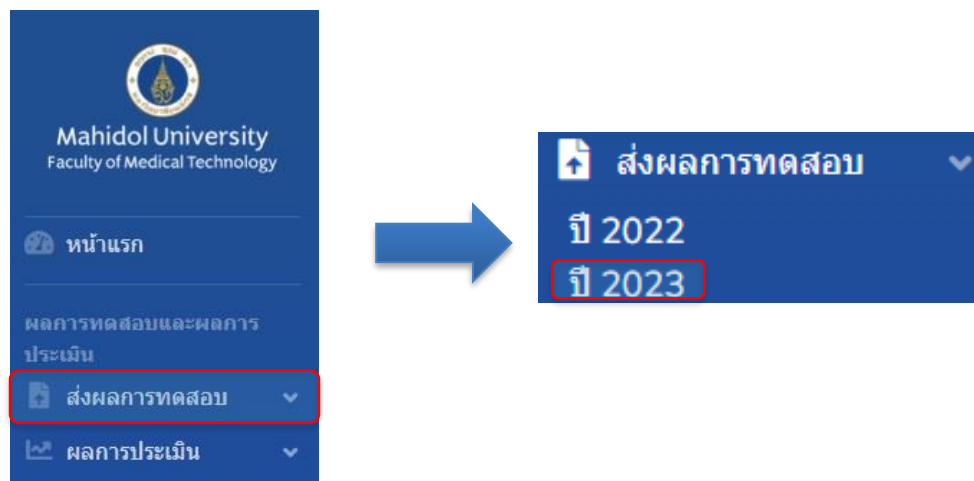

3. เลื่อนหา “EQAI:Syphilis” กดที่ “Trial”

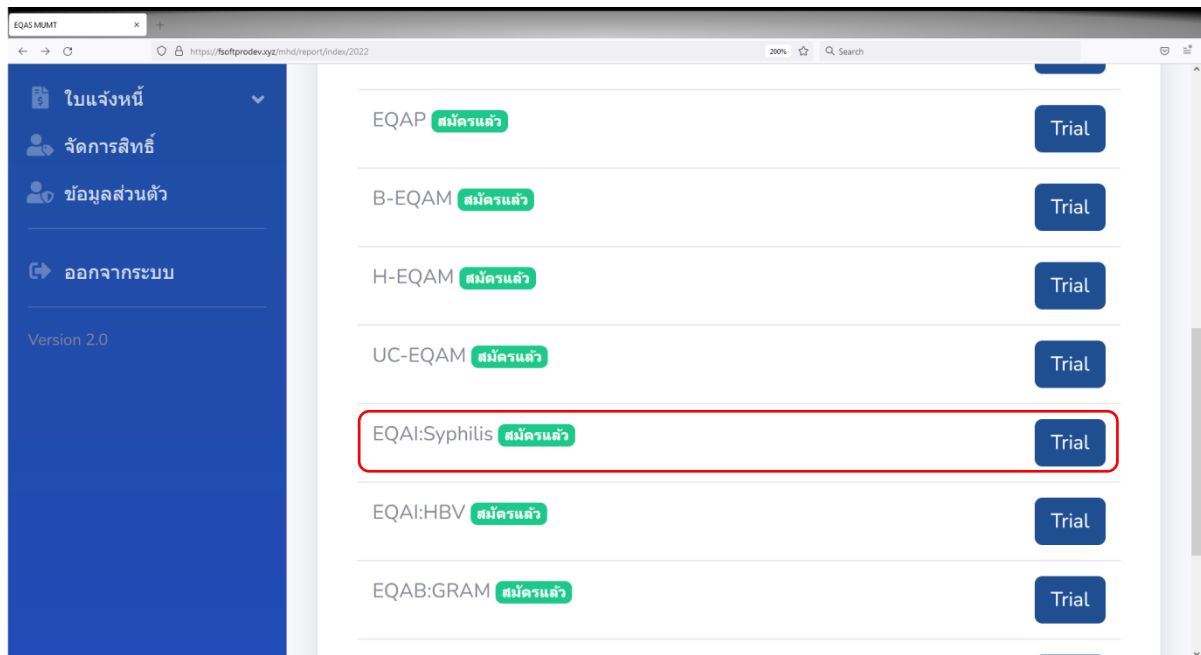

4. กดที่ “รายงานผล”

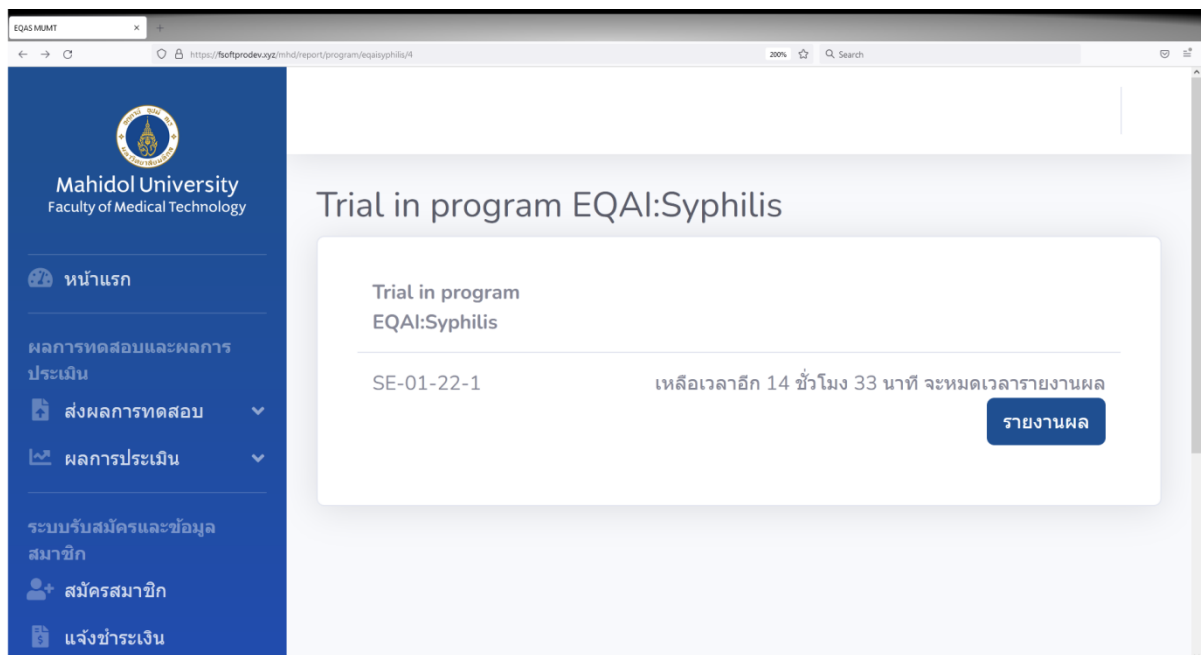

5.ทำการเลือก “วันที่ได้รับตัวอย่างทดสอบ” และ “ความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ”

6.เมื่อทำการเลือก “ความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ” จะปรากฏในส่วนของการรายงานผลของ specimen ในหน้าเดียวกันให้ทำการเลื่อนลงมาด้านล่าง

7.Non Treponemal Test

7.1 ให้ทำการเลือก “Method” (ต้องใส่)

หากไม่มี “Method” ในตัวเลือกที่ตรงกัน ให้เลือก “Other” แล้วพิมพ์ชื่อ Method ที่ถูกต้อง

7.2 ทำการพิมพ์ชื่อ Instrument/Test Kit/Brand (ต้องใส่)

7.3 ทำการพิมพ์ Reagent Lot Number (ต้องใส่)

7.4 ในส่วนของการรายงานผลของ specimen

ในช่อง Qualitative ให้ทำการเลือกคำตอบตามผลการทดสอบ (Reactive/Weakly Reactive/Non-reactive)

ถ้าเลือกคำตอบเป็น Reactive ให้ทำการเลือกคำตอบในส่วนของ Semiquantitative ตามผลการทดสอบ

ถ้าเลือกคำตอบเป็น “Weakly Reactive” หรือ “Non-reactive” ไม่ต้องทำการเลือกคำตอบในส่วนของ Semiquantitative

8.Treponemal Test

Version 2.0

EQAI MUMT

https://sfctprodev.xyz/mhd/report/brial/eqaisyphilis/se-01-22-1

120% Search

Non treponemal Test

Choose Method

Instrument/Test Kit/ Brand

Reagent Lot Number

Specimen No.	Qualitative	Semiquantitative
SE-01-22-1-1	Choose	Semiquantitative
SE-01-22-1-2	Choose	Semiquantitative
SE-01-20-1-3	Choose	Semiquantitative
SE-01-20-1-4	Choose	Semiquantitative

Treponemal Test

Choose Method

Instrument/Test Kit/ Brand

Reagent Lot Number

Qualitative

Choose

Choose

Choose

Choose

ข้อมูลผู้ส่ง

ชื่อ: ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลดีดัดแปลง

หมายเลขโทรศัพท์: 024123441

ตำแหน่ง: ตำแหน่ง

ชื่อศิลปินหรือเลขทะเบียนเพื่อการพัฒนารับปรุง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

8.1 ให้ทำการเลือก “Method” (ต้องใส่)

หากไม่มี “Method” ในตัวเลือกที่ตรงกัน ให้เลือก “Other” แล้วพิมพ์ชื่อ Method ที่ถูกต้อง

8.2 ทำการพิมพ์ชื่อ Instrument/Test Kit/Brand (ต้องใส่)

8.3 ทำการพิมพ์ Reagent Lot Number (ต้องใส่)

8.4 ในส่วนของการรายงานผลของ specimen

ในช่อง Qualitative ให้ทำการเลือกคำตอบตามผลการทดสอบ (Reactive/Weakly Reactive/Non-reactive)

11.เมื่อทำการรายงานผลเสร็จแล้ว ให้ทำการกรอกข้อมูลตามที่ปรากฏด้านล่าง เมื่อเสร็จแล้ว ให้ทำการกดที่ “ส่งผลการตรวจ”

ข้อมูลผู้ส่ง

ชื่อ: ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการ

หมายเลขโทรศัพท์: 0241234

ตำแหน่ง: ตำแหน่ง

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง: ความคิดเห็นเพิ่มเติม

วันที่ทำการทดสอบ: 14-01-2022

ส่งผลการตรวจ

10.จากนั้นจะปรากฏข้อความมุมบนขวาให้เลือก “พิมพ์” หรือ “ยืนยันส่งผลการตรวจ” เมื่อทำการตรวจทานข้อมูลที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดที่ “ยืนยันส่งผลการตรวจ” เป็นอันเสร็จสิ้น

รายงานผลการทดสอบ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์: 2 วิจัย สิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

บันทึกการรับตัวอย่าง: Scheme : EQAI-Syphilis Trial : SE-01-22-1

วันที่ได้รับตัวอย่างทดสอบ: 14-01-2022


ความสมบูรณ์ของตัวอย่างทดสอบ: อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถนำมาทดสอบได้

เนื่องจาก:

Non treponemal Test			Treponemal Test		
Choose	Method		Choose	Method	
	Instrument/Test Kit/ Brand			Instrument/Test Kit/ Brand	
	Reagent Lot Number			Reagent Lot Number	
Specimen No.	Qualitative	Semiquantitative	Qualitative		
SE-01-22-1-1	Choose	Semiquantitative	Choose		

พิมพ์ **ยืนยันส่งผลการตรวจ**

11.เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการส่งผลการตรวจแล้ว หน้าต่างสำหรับหลังย้อนดูผลการตรวจ หากมีการแก้ไข ให้กด”ดูรายงานที่เคยส่ง”

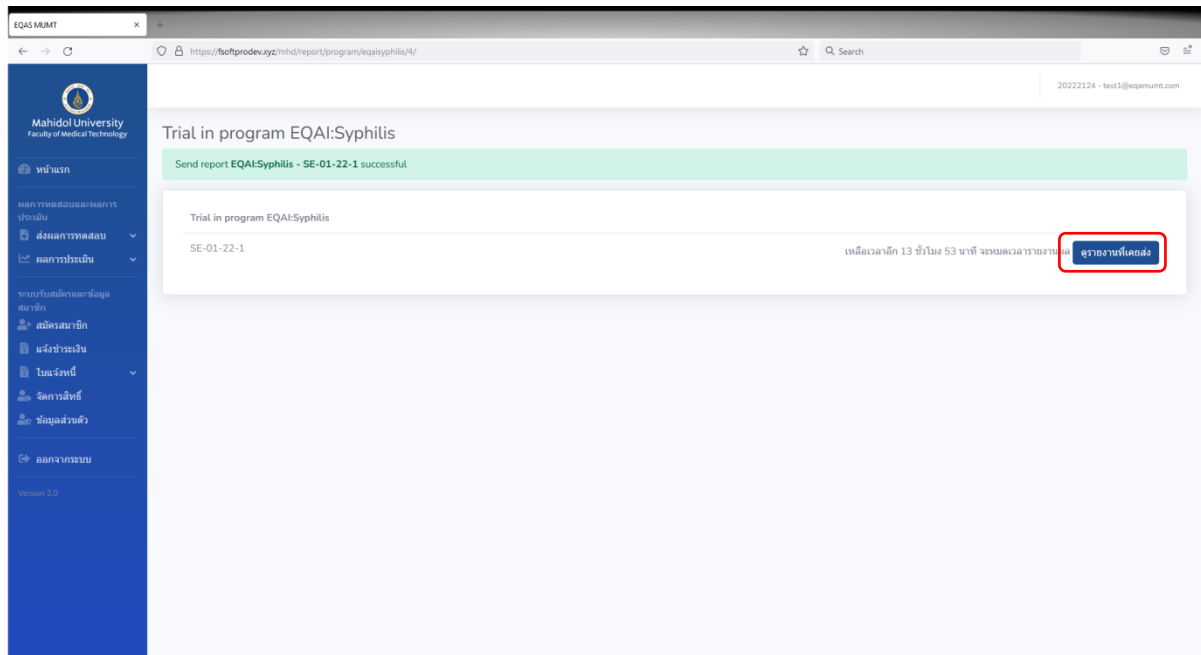

12.ตรวจสอบผลการประเมินออนไลน์สามารถกดที่ “ผลการประเมินปี 2023” ทำการเลือกโครงการ “EQAI:Syphilis” จากนั้นกดที่ “Trial” เลือก Trial ที่ต้องการจากนั้นกดที่ “ผลการประเมิน” จะปรากฏในหน้าดาวน์โหลดไฟล์ ทำการดาวน์โหลดไฟล์ผลการประเมิน เป็นอันเสร็จสิ้น

